


Prescription destinée à  
M. \_\_\_\_\_



**TRAV-LER®** ● Protection anti-bactérienne des brins - Blister de 4

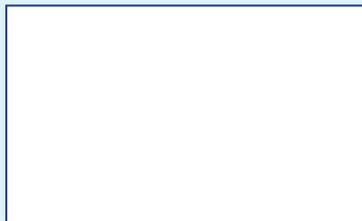

- |                          |             |           |  |        |       |  |
|--------------------------|-------------|-----------|--|--------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>1312</b> | 520 341 7 |  | 0,6 mm | ISO 0 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1314</b> | 478 864 0 |  | 0,8 mm | ISO 1 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1412</b> | 767 750 4 |  | 0,9 mm | ISO 2 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1414</b> | 767 751 0 |  | 1,1 mm | ISO 3 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1512</b> | 767 752 7 |  | 1,2 mm | ISO 3 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1514</b> | 767 753 3 |  | 1,3 mm | ISO 4 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1612</b> | 767 755 6 |  | 1,4 mm | ISO 4 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1614</b> | 767 756 2 |  | 1,6 mm | ISO 5 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1618</b> | 478 865 7 |  | 2,0 mm | ISO 6 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>1619</b> | 624 371 0 |  | 2,6 mm | ISO 7 |  |

- 1699** 627 429 6 *Multipack*  
(10 brosselettes)



**BI-DIRECTION** ● Orientable en 2 positions - Blister de 6  
Simple d'utilisation

- |                          |             |           |  |        |       |  |
|--------------------------|-------------|-----------|--|--------|-------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>2014</b> | 628 083 5 |  | 0,6 mm | ISO 0 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>2114</b> | 450 734 5 |  | 0,7 mm | ISO 1 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>2314</b> | 435 688 6 |  | 0,9 mm | ISO 2 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>2614</b> | 435 689 2 |  | 1,2 mm | ISO 3 |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>2714</b> | 628 083 4 |  | 1,4 mm | ISO 4 |  |

**SOFT-PICKS®** ● Bâtonnet caoutchouc



- |                          |            |           |                     |                |  |
|--------------------------|------------|-----------|---------------------|----------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>689</b> | 634 570 9 | <b>PRO Small</b>    | <b>NOUVEAU</b> |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>690</b> | 634 571 5 | <b>PRO Medium</b>   |                |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>691</b> | 634 571 2 | <b>PRO Large</b>    |                |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>669</b> | 632 672 1 | <b>MINTY Small</b>  |                |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>670</b> | 621 489 3 | <b>MINTY Medium</b> |                |  |
| <input type="checkbox"/> | <b>671</b> | 632 672 0 | <b>MINTY Large</b>  |                |  |

**PerioBalance®** ●

à base de *Limosilactobacillus reuteri* Prodentis®

- 7010** 462 624 5 *Probiotiques*  
30 comprimés



**GUM® PAROEX®** ●

- 1770** 720 843 6 *Gel dentifrice*  
75 ml





# BROSSETTES INTERDENTAIRES

## MODE D'UTILISATION

- 1 Utiliser une brosse à dents interdentaire avant le brossage des dents.
- 2 Glisser délicatement la brosse à dents interdentaire dans l'espace interdentaire et effectuer au moins 6 mouvements de va-et-vient. Ne pas «forcer» l'insertion d'une brosse à dents interdentaire si l'espace est trop étroit.
- 3 Rincer la brosse à dents interdentaire sous l'eau après utilisation. Jeter la brosse à dents interdentaire dès usure (entre 7 et 10 jours après la première utilisation).


## TRAV-LER

Plier la brosse à dents interdentaire au niveau du manche pour un meilleur accès au secteur postérieur.  
Ne pas plier la tige métallique au risque de la casser.



## BI-DIRECTION


Faire glisser le poussoir vers l'avant ou l'arrière pour orienter la tête de la brosse à dents interdentaire.  
(180° : secteur antérieur - 90° : secteur postérieur)



## NOTE / PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

La marque GUM est disponible **exclusivement en pharmacies et parapharmacies**.  
Liste de points de vente et informations complémentaires sur [SunstarGUM.fr](http://SunstarGUM.fr)

PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ

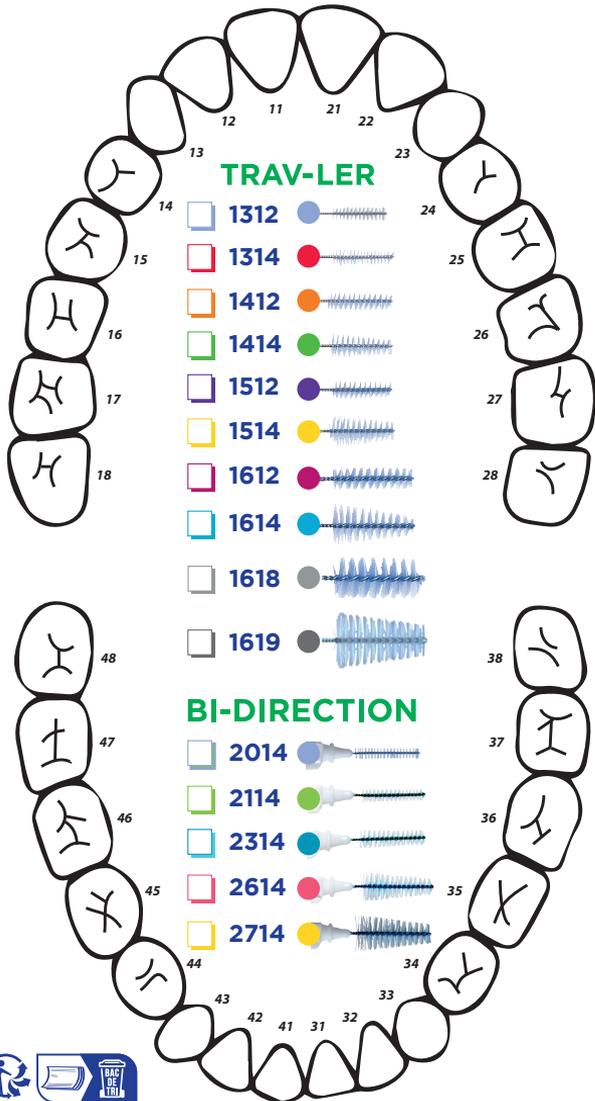

Brossettes à taille réelle

